

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 6. 7. 2020, številka objave JN004262/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 7. 7. 2020, številka objave 2020/S 129-315777.

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Navodila za delo s programom »Javna naročila«
 - 1. Obrazec ponudbe (OBR-1)
 - 2. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-2)
 - 3. Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3)
 - 4. Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-4)
 - 5. Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-5)
 - 6. Specifikacija zahtev naročnika
 - 7. Priloga k Specifikaciji zahtev naročnika
 - 8. Specifikacija ponudbe s cenami

Priloga:

- obrazec ESPD (Narocnik_ESPD_MPM_za_anesteziologijo.xml)
- Računalniški program »Javna naročila« (setup_JN.exe)

Številka povabila: 460-DeS-V1-77/20
Datum: 3. 7. 2020

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za blago:

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:
**MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA
ANESTEZIOLOGIJO**

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

I SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	<p>MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO</p> <p>Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev naročnika, v Prilogi k specifikaciji zahtev naročnika in v točki 2.11 teh navodil.</p> <p><u>Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezno skupino blaga.</u></p> <p><u>Ponudniki morajo ponuditi vse razpisane vrste blaga iz posamezne skupine blaga (100% skupina)!</u></p>
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 , v nadaljevanju ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.
Trajanje naročila:	Tri (3) leta od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.
Rok za oddajo ponudb:	Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 do 7. 8. 2020 do 12:00 ure (Glej točko 2.4 teh navodil).
Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 8. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 (Glej točko 2.5 teh navodil).

V primeru, da bo naročnik prejel ponudbe, ki bodo višje od zagotovljenih sredstev, si pridržuje pravico, da:

- javnega naročila ne odda v celoti,
- javnega naročila ne odda v delu (posamezna skupina blaga), kjer ponudba presega zagotovljena sredstva,
- količine blaga, pri katerem ponudbena cena presega zagotovljena sredstva, zmanjša.

Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma predvidoma v obdobjih, kot je opredeljeno v točki 4.2 teh navodil. Naročilo za posamezno obdobje bo oddano, na podlagi merila iz točke 2.13 teh navodil, tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo za posamezno skupino blaga med sklenitelji okvirnega sporazuma najugodnejši.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom v posameznem obdobju sklenil kupoprodajno pogodbo.

V primeru, da bo naročnik za posamezno skupino blaga prejel samo eno dopustno ponudbo, bo naročnik s tem ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, za obdobje treh (3) let od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik v tem primeru ne bo odpiral konkurence.

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila, kot so navedena v točki 2.10 teh navodil.

1.2.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.10 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Obrazca »Specifikacija ponudbe s cenami in Specifikacija zahtev naročnika« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed partnerjev, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju) v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 28. 7. 2020 do 12:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.ukc-mb.si>) in na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

¹ <http://www.enarocanje.si>

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-1);
2. izpolnjen vzorec okvirnega sporazuma (OBR-2);
3. izpolnjen vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3);
4. soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-4);
5. soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-5);
6. izpolnjen obrazec Specifikacija zahtev naročnika (**izpolnjen za vse skupine blaga za katere oddaja ponudbo; izpis + podatki.dat**)*;
7. izpolnjen obrazec Specifikacija ponudbe s cenami (**izpolnjen za vse skupine blaga za katere oddaja ponudbo; izpis + podatki.dat**)*;
8. izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
9. **specifikacijo ponujene opreme dane v brezplačno uporabo na lastnem obrazcu ponudnika; naveden mora biti tip ponujene opreme, proizvajalec in količina**;
10. ES izjavo o skladnosti za ponujeni aparat.

***Opomba k točki 6 in 7:** Ponudnik izpolni obrazec Specifikacije zahtev naročnika in obrazec Specifikacije ponudbe s cenami z računalniškim programom »Javna naročila«. Ponudnik naredi izpis, ki ga podpiše in skenira v PDF datoteko. Zraven izpisa morajo ponudniki pripraviti tudi podatkovne datoteke za potrebe Centra za informatiko naročnika (glej navodila za delo s programom »Javna naročila«). **Datoteke (Opisi.tps, Podatki.dat in Ponudnik.dat), ki bi jih drugače program »Javna naročila« kreiral na prenosnem mediju (CD, USB ključek), je potrebno priložiti v ponudbi oz. naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«!** V kolikor imajo ponudniki težave s programom »Javna naročila« oz. pri pripravi podatkovnih datotek, se lahko obrnejo na: Center za informatiko – Janez Kremlj, tel.: 02/321-27-30.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseb. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca (je pa zaželeno).

Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami (**izpolnjen za vse skupine blaga za katere oddaja ponudbo**)« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V specifikaciji zahtev naročnika mora ponudnik obvezno vpisati pri vsaki vrsti blaga naslednje podatke:

- pakiranje*,
- proizvajalca,
- zaščiteno ime,
- kataloško številko ali kakšno drugo oznako za identifikacijo blaga.

***Opomba:**

V stolpec »Pakiranje« mora ponudnik navesti dejansko količino blaga v ponudnikovem osnovnem pakiranju (število kosov blaga v škatli/paketu/ ...).

V primeru, da naročnik na enem identu razpisuje več dimenzij, mora ponudnik priložiti specifikacijo s kataloškiimi številkami za vse ponujene dimenzije oz. v primeru razpisanih kompletov specifikacijo s cenami in kataloškiimi številkami za vse posamezne elemente kompleta. Postopek vpisa je opisan v dodatnih navodilih za delo s programom »Javna naročila«.

V specifikacijo ponudbe s cenami je treba vpisati:

- ceno brez DDV,
- davčno stopnjo (%).

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od razpisanega, mora ponujeno ceno preračunati na razpisano pakiranje.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-1),
- ESPD obrazec.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

ESPD obrazec

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev (točka 2.10.1 teh navodil) in dokaz o izpolnjevanju posameznega pogoja iz točke 2.10.2 teh navodil, vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v tej dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo potrdila ali druge informacije naročnik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če gospodarski subjekt predloži dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si naročnik pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

Gospodarski subjekt si mora naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) shraniti na svoj računalnik, ter ga nato uvoziti na portal javnih naročil² (izberete zavihek ESPD in nato označite »sem gospodarski subjekt«). Pri shranjevanju citirane datoteke ne smete spreminjati končnice datoteke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

2.4 Način in rok predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2> v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika³). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do 7. 8. 2020 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni

² www.enarocanje.si

³ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=19356

2.5 Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **7. 8. 2020** in se bo začelo **ob 12:05 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

2.6 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.7 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.8 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.9 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 5 delovnih dni. V kolikor ponudnik zahtevanega prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih

ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnega postopka oddaje javnega naročila.

2.10 Ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.10.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16 – popr.](#), [54/15](#), [38/16](#), [27/17](#) in [23/20](#); v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- škčuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.10.2 Pogoji za sodelovanje

2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednja pogoja:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji)

oziroma v primeru tujega ponudnika

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11 Tehnične specifikacije

V Specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila. Tehnične zahteve so opredeljene v tej točki, v Specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k Specifikaciji zahtev naročnika.

Strokovne zahteve za aparat za avtologno transfuzijo:

Ponudnik mora ponuditi v brezplačno uporabo 7 aparatov za avtologno transfuzijo, ki so kompatibilni s ponujenim potrošnim materialom za čas trajanja okvirnega sporazuma/kupoprodajne pogodbe in zagotoviti brezplačni servis. Delovanje aparata mora izpolnjevati vse strokovne zahteve, ki so opisane v specifikacijah pod identi **424722**, **424714** in **485225**.

Specifikacija opreme dane v brezplačno uporabo, mora biti priložena v ponudbi. Naveden mora biti tip ponujene opreme, proizvajalec in količina.

V primeru če je naročnik navedel določeni standard, mora ponujeno blago ustrezati standardu navedenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali enakovrednemu standardu.

Vse ponujene vrste blaga morajo imeti CE oznako, ki jo bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov.

2.12 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR).

Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špeditorske, carinske ter morebitne druge stroške), popuste in rabate. Posebej je treba izkazati stopnjo davka na dodano vrednost.

Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške.

Cena na enoto mere mora biti fiksna v času trajanja kupoprodajne pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz točke 4.2 teh navodil oz. v primeru, da bo naročnik za posamezno

skupino blaga prejel samo eno dopustno ponudbo, mora biti cena na enoto mere fiksna za več čas trajanja okvirnega sporazuma.

2.13 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna vrednost posamezne skupine blaga brez DDV.**

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako vrednost brez DDV za isto skupino blaga, bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki bo prej oddal ponudbo.

2.14 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno vrednost posamezne skupine blaga brez DDV.

Izbrani ponudnik **mora v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- **svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;**
- **gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.**

2.15 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do **7. 2. 2021.**

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.16 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III FINANČNA ZAVAROVANJA

3.1 Vrste finančnih zavarovanj

Izbrani ponudnik bo moral v roku 5-ih dni od podpisa okvirnega sporazuma in/oz.kupoprodajne pogodbe naročniku predložiti:

1. garancijo (banke oz. zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti oz. vrednosti okvirnega sporazuma v primeru, da bo vrednost enaka ali višja od 214.000,00 EUR brez DDV; oz.
2. menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od pogodbene vrednosti oz. vrednosti okvirnega sporazuma v primeru, da bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 214.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe oz. okvirnega sporazuma menica unovčljiva.

Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka mora biti še najmanj 10 dni od veljavnosti pogodbe oz. okvirnega sporazuma.

Opomba

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno menico oz. bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje ustrezno nadomestiti z novo.

IV SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KUPOPRODAJNE POGODBE

4.1 Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da so njihove ponudbe dopustne, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 2 točke 2.3 teh navodil. Okvirni sporazum se sklene za obdobje treh (3) let od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

4.2 Predvidena obdobja

Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma predvidoma v naslednjih obdobjih:

- 12 mesecev od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila (prvo obdobje);
- 12 mesecev od poteka prvega obdobja (drugo obdobje);
- 12 mesecev od poteka drugega obdobja (tretje obdobje).

V posameznem obdobju bo naročnik med sklenitelji okvirnega sporazuma izbral najugodnejšega ponudnika iz predmetnega naročila na podlagi merila iz točke 2.13. teh navodil.

V primeru, da bo naročnik za posamezno skupino blaga prejel samo eno dopustno ponudbo, naročnik za te skupine blaga ne bo odpiral konkurence. V takem primeru bo naročnik s tem ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, za obdobje od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

4.3 Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na podlagi merila iz točke 2.13. teh navodil, sklenil kupoprodajno pogodbo po določitih vzorca kupoprodajne pogodbe iz točke 3 točke 2.3 teh navodil.

Kupoprodajno pogodbo je treba podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu kupoprodajne pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

V KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz okvirnega sporazuma, kupoprodajne pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojuje posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

VI PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-1I, [60/17](#) in [72/19](#)), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00426220.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico na naslov naročnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.


C) NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA"

I. POTEK NAMESTITVE PROGRAMA:

1. V okolju Okna XP, VISTA, Windows 7, Windows 10 izberite ikono **START** | **ZAŽENI** | vpišite **CD ENOTA:SETUP** | pritisnite **ENTER**.

Če uporabljate Windows z angleškimi ukazi pa izberite **START** | **RUN** | vpišite **ENOTA:SETUP** | pritisnite **ENTER**.

2. Sledite navodilu za namestitev programa (3x kliknite naprej in 1x »Zaključí«). Privzeti cilj namestitve programa lahko poljubno spreminjate.

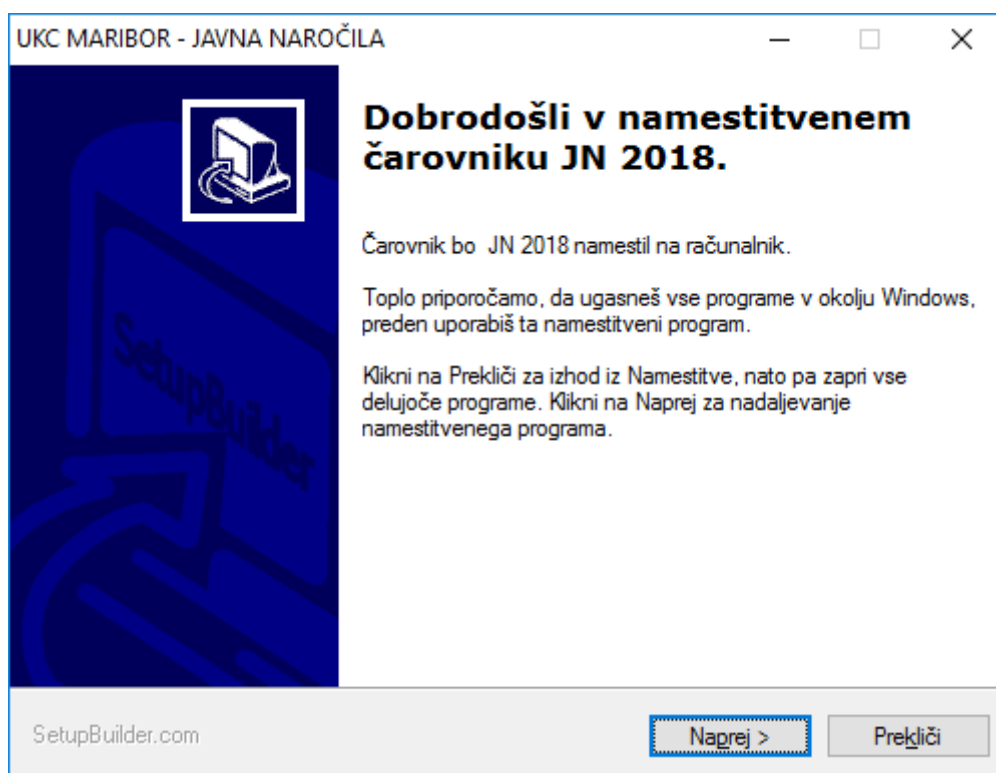

Izberi ciljno mapo

Ciljna mapa

Klikni na Naprej za namestitev v to mapo ali na Spremeni za namestitev v drugo mapo.

Prosim, vnesi lokacijo, kamor želiš namestiti program. Lahko vpišeš mapo z novim imenom ali klikneš na Spremeni, če želiš poiskati novo lokacijo.

Namesti JN 2018 v:

c:\UKC MB\JN 2018

Spremeni...

SetupBuilder.com

< Nazaj Naprej > Prekliči

Pripravljen na namestitev

Pripravljen za namestitev programa.

Čarovnik je pripravljen na namestitev.

Če želiš pregledati ali spremeniti namestitvene nastavitve, klikni na Nazaj. Klikni na Prekliči za izhod iz čarovnika.


Trenutne nastavitve:

Ciljna mapa:
c:\UKC MB\JN 2018

Potrebni prostor na disku
7,597K


SetupBuilder.com

< Nazaj Naprej > Prekliči



3. Po uspešni namestitvi se bo prikazalo sporočilo z opozorilom, da je program uspešno nameščen.

Zdaj so se na vašem računalniku ustvarile naslednje bližnjice v skupini **PROGRAMI**:



➤ **Javna naročila UKC MARIBOR** - glavni program za:

- vpis cen
- vpis podatkov o artiklu

↪ **Odstranitev programa** (briši program iz sistema)

4. Sedaj ste opravili vse potrebne prenose za delo s programom Javna naročila UKC Maribor (glej točko II).

II. DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA UKC MARIBOR"

Program poženete s klikom na:

START | PROGRAMI | UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2018 - | Javna naročila UKC MARIBOR.

JN UKC MARIBOR - PONUDBA za JN 2019

Datoteka Ponudba Dodatni opisi Oddaja podatkov na portal Vizitka

Nastavitev tiskalnika...

Izvoz podatkov v excel

Uvoz podatkov iz excel-a

Podatki o ponudniku

Izhod

11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1 št. zapisov s ceno = 0: 1

BLAGO - OSNOVNI PODATKI					CENA brez DDV, stopnja DDV				KOLIČINA		Proizvajalec	
JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	nabave	pogodbene		
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL						144	144	

Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo

Proizvajalec: Kataloška: Paralela: Pakiranje: 0

Zahteve naročnika Ponudba s cenami Uporabniki Dopolni ponudbo Ponudnik Briši Zapi

JN UKC MARIBOR - PONUDBA za JN 2019

Datoteka Ponudba Dodatni opisi Oddaja podatkov na portal Vizitka

11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1 št. zapisov s ceno = 0: 1

BLAGO - OSNOVNI PODATKI					CENA brez DDV, stopnja DDV				KOLIČINA		Proizvajalec	
JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	nabave	pogodbene		
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL						144	144	

Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo

Proizvajalec: Kataloška: Paralela: Pakiranje: 0

Zahteve naročnika Ponudba s cenami Uporabniki Dopolni ponudbo Ponudnik Briši Zapi

Meniji:

a) Datoteka

- *Nastavitev tiskalnika* (izberemo privzeti tiskalnik)
- *Izvoz podatkov v Excel* (prenos podatkov v Excel obliko)
- *Uvoz podatkov iz Excel-a* (uvoz podatkov iz Excel oblike)
- *Podatki o ponudniku* (vpišete vaše podatke; ki se izpišejo na specifikaciji ponudbe)
- *Izhod* (zaključek dela s programom)

b) Ponudba (glavni del programa)

☞ V tem meniju boste dobili možnost **pregleda vseh podatkov po skupinah**. Izdelek lahko iščete po skupini ali po nazivu. Omogočen je tudi prikaz tistih artiklov za katere ni vpisana cena (izbor : **CENA = 0**).

☞ (Vnos in) Spreminjanje podatkov

Podatek vnesete in spremenite tako, da označite vrsto blaga in izberete "**Dopolni ponudbo**" ali pritisnete "**Alt+D**" ali pa izberete "**ENTER**". Prikaže se vam novo okno v katerega vpišete vaše podatke. Za skupine je :

- **omogočen** vpis podatkov kot so: proizvajalec, zaščiteno ime, pakiranje, kat. št.
- **omogočen** vpis podatkov kot so: pakiranje, cena brez DDV in stopnja DDV. V kolikor ne želite podati ponudbe za določen artiklov, ne vpišete nobenega podatka v omenjena polja.

Če ste podatke pravilno vpisali in izbrali "**Potrdi**", se bodo vpisani ali spremenjeni podatki prikazali pri izbranem artiklu.

JN UKC MARIBOR - PONUDBA za JN 2019

Datoteka Ponudba Dodatni opisi Oddaja podatkov na portal Vizitka

11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR)

Naziv materiala: š. vseh zapisov: 1 št. zapisov s ceno = 0: 1

JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	stopnja DDV	Rabat%	DDV%	KOLIČINA nabave	pogodbene	Proizvajalec
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL						144	144	

PODATKI O PONUDBI

Ponudba

IZHODIŠČNI PODATKI

šifra JR: 11 Skupina: 01 Ident JN: 911001

Naziv materiala: Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo

PODATKI O BLAGU

Proizvajalec: Uporabnik:

Paralela/Zaščiteno ime:

Kataloška številka:

Pakiranje (numerično):

CENA brez DDV, stopnja DDV

Cena brez DDV: 0,0000 € stopnja DDV: ☐ 0% ☐ 9.5% ☒ 22%

MDC brez DDV: 0,0000 €

Rabat:

KOLIČINA

Letna: 144 KPL

Predvidena: 144 KPL

Zahteve naročnika

Dodatni opisi

Dodatne opise za posamezne artikle lahko vpišete če v osnovnem meniju izberete možnost »**Dodatni opisi**« / »**Vnos in urejanje**«. Po izboru ustreznega artikla lahko dodajate, spreminjate ali brišete dodatne opise posameznih artiklov (izbor »**Dodaj**«, »**Uredi**« ali »**Briši**«). Izpis tako urejenih dodatnih opisov lahko naredite z izborom možnosti »**Tiskaj**«. Izvoz in uvoz podatkov je omogočen z izborom »**Izvoz podatkov v excel**« ali »**Uvoz podatkov iz excela-a**«.

JN UKC MARIBOR - PONUDBA za JN 2019

Datoteka Ponudba **Dodatni opisi** Oddaja podatkov na portal Vizitka

Vnos in urejanje

Izvoz podatkov v excel

Uvoz podatkov iz excel-a

Izvoz Uvoz

JN 11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Izberi skupino: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1

BLAGO - OSNOVNI PODATKI

JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL

Kataložka Opis

+ Dodaj Uredi Briši

Tiskaj Zapri

JN 11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI

po nazivu Izberi skupino: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1

BLAGO - OSNOVNI PODATKI

JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL

Kataložka

JN KATALOŽKA ŠTEVILKA Z DODATNIM OPISOM

OPISI

JR: 11

SK: 01

Ident JN: 911001

Naziv: Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo

Kataložka: opis:

OK Opusti

Izpisa specifikacije

11 SRČNI SPODBUJEVALNIKI








po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR)

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 1 št. zapisov s ceno = 0: 1

BLAGO - OSNOVNI PODATKI				CENA brez DDV, stopnja DDV				KOLIČINA		Proizvajalec
JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	nabave	
11	01	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL					144	144

Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo

Proizvajalec: Kataloška: Paralela: Pakiranje: 0

Če izberete polje **"Zahteve naročnika"** boste dobili izpis *"Specifikacija zahtev naročnika"*.

Predogled izpisa

Datoteke

Stran: 1 od 5

Stran za izpis: 1

Šteje: 1

PONUDNIK: NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.05.2018
Stran: 1

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JR: 11 Srčni spodbujevalniki
01 Srčni spodbujevalniki, tip SSIR (VVIR/AAIR)


GPV: 33162210

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Spodbujevalnik SSIR s pripadajočo elektrodo	911001	KPL	144				

ŽIG IN PODPIS:

Če označite polje **"Ponudba s cenami"** boste dobili izpis *"Specifikacija ponudbe s cenami"*.

9

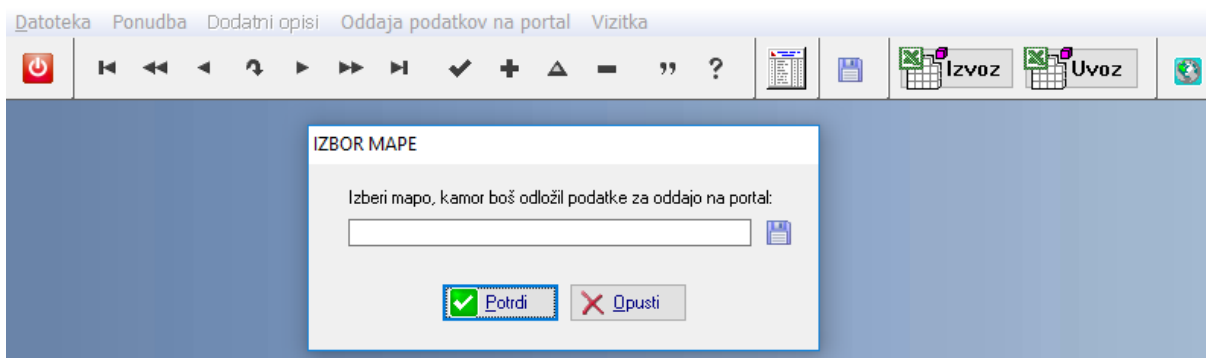**Opozorilo:**

Pred pripravo podatkov/cen za oddajo na portal morate biti v osnovnem meniju. Če boste poskušali shraniti podatke in boste imeli odprto datoteko s podatki (na zaslonu se vidi okno s podatki), se bo računalniški program odzval z opozorilom, da je pristop do podatkov onemogočen. Po prenosu podatkov preverite ali so podatki dejansko shranjeni v izbrano mapo ali medij. Datoteke priložite k ponudbi na portalu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml.

e) Vizitka

Ta izbira vam bo dala na zaslonu podatke o kontaktni osebi iz UKC Maribor v primeru morebitnih nejasnosti v zvezi s samim programom: Center za informatiko – Janez Kremlj, tel.: 02/321-27-30.

ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO!

PONUDBA

Skupna ponudba: (navesti: DA/NE).¹

<p>1. Opis predmeta javnega naročila: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO</p> <p>Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 6. 7. 2020, številka objave JN004262/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 7. 7. 2020, številka objave 2020/S 129-315777.</p>
<p>2. Ponudbena vrednost v EUR brez DDV:</p>
<p>3. Podatki o ponudniku</p>
<p>3.1 Firma oz. ime:</p>
<p>3.2 Naslov:</p>
<p>3.3 Zakoniti zastopnik:</p>
<p>3.4 Identifikacijska številka za DDV:</p>
<p>3.5 Matična številka:</p>
<p>3.6 Številka transakcijskega računa:</p>
<p>3.7 Telefonska številka:</p>
<p>3.8 Številka telefaksa:</p>
<p>3.9 E-mail ponudnika:</p>
<p>3.10 Kontaktna oseba:</p>
<p>3.11 Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe:</p>

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

¹ V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
(v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI 56644817,
matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

.....,
ki ga zastopa direktor
(v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV:
....., matična številka stranke sporazuma:

I UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednje stranke sporazuma:

1.
2.
3.
- N.

Naročnik in stranke tega sporazuma ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za nabavo blaga: »**MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO**«, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#) in [14/18](#), v nadaljevanju ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave 6. 7. 2020, številka objave JN004262/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 7. 7. 2020, številka objave 2020/S 129-315777.

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.

II PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Stranki sporazuma sklepata ta sporazum za posamezne skupine blaga opredeljene v Seznamu blaga (v nadaljevanju: Seznam).

Ponudba, Seznam iz tega člena, in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del tega sporazuma.

Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od stranke sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo potreboval v tem obdobju.

Količine blaga so okvirne. Naročnik se ne obvezuje stranki sporazuma oddati določene količine blaga.

V primeru osmega odstavka 4. člena tega sporazuma so predmet tega sporazuma tudi vse morebitne dodatne nabave blaga, ki jih bo potreboval naročnik. Navedene nabave blaga bo naročnik izvršil po cenah iz prvotne ponudbe, pri čemer se lahko sporazum spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje količine iz sporazuma ne sme presegati 30% prvotno predvidenih skupnih količin blaga (prvi odstavek 95. člena ZJN-3).

Za izvršitev zgoraj navedenih dobav bosta stranki tega sporazuma sklenili aneks k tem sporazumu.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, brez predhodne najave, zmanjša ali prekine nabavo določenih vrst blaga.

III IZVAJANJE SPORAZUMA – PREDLOŽITEV PONUDB

4. člen

Sporazum se sklepa za obdobje treh (3) let od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je čas trajanja tega sporazuma iz prvega odstavka tega člena razdelil na naslednja obdobja:

- 12 mesecev od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila (prvo obdobje);
- 12 mesecev od poteka prvega obdobja (drugo obdobje);
- 12 mesecev od poteka drugega obdobja (tretje obdobje).

Naročnik bo določen čas pred začetkom drugega in tretjega obdobja iz predhodnega odstavka tega člena odpiral konkurenco med strankami tega sporazuma tako, da bo stranke sporazuma pozval k predložitvi ponudb za tiste skupine blaga, za katere je sklenjen sporazum. V posameznem obdobju bo naročnik med tistimi strankami tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe, izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbe bo treba predložiti v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb za posamezno obdobje.

Naročnik bo odločitev o oddaji posameznega naročila na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji sporazuma objavil na portalu javnih naročil.

Z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo.

Naročnik bo ponovno odpiral konkurenco, za preostali čas do izteka veljavnosti obdobja, med ostalimi sklenitelji sporazuma, v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo želel skleniti pogodbe,
- če bo naročnik prekinil pogodbo z izbranim ponudnikom,
- če bo izbrani ponudnik odstopil od pogodbe.

V primeru, da bo naročnik za posamezne skupine blaga sklenil sporazum s samo eno stranko sporazuma, naročnik ne bo odpiral konkurence za te skupine blaga. Te skupine blaga bodo v Seznamu ustrezno označene.

IV CENE

5. člen

Naročnik bo nabavljal posamezne vrste blaga, iz Seznama po cenah iz ponudbe.

Cene za posamezne vrste blaga iz ponudbe so fiksne v času trajanja posamezne pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz 4. člena tega sporazuma.

V primeru, da bo naročnik za posamezne skupine blaga sklenil sporazum s samo eno stranko sporazuma, so cene za posamezno vrsto blaga fiksne za ves čas trajanja tega sporazuma.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz sporazuma.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špeditski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

6. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od stranke sporazuma na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo blago dobavila najkasneje v roku petih delovnih (5) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavila celotno količino naročenega blaga.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo ob dobavi naročniku predložila navodila proizvajalca v slovenskem jeziku.

Dobavni rok se lahko v soglasju z naročnikom podaljša, v kolikor pravočasna dobava ni mogoča iz razlogov razglašene epidemije, o čemer mora stranka sporazuma naročnika nemudoma obvestiti. Podaljšanje roka iz tega naslova je mogoča le v obdobju trajanja epidemije in v skladu z veljavno zakonodajo.

Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče naročnika.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbela za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dostave blaga.

Stranka sporazuma bo, v primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje,) oz. v primeru nadgradnje blaga (novejša generacija) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložila razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobila pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

VI PREVZEM BLAGA

7. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi e-dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po e-dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataložsko številko.

Kataložske številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, ...) na vseh dokumentih (e-dobavnica, račun) in nalepki blaga ter škatli.

Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke o artiklu in črtno kodo, ki vsebuje serijsko številko in lot.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

VII KAKOVOST BLAGA

8. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

VIII KRITNI KUP

9. člen

Če stranka sporazuma ne dobavlja blaga v skladu s tem sporazumom in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju oz. stranki sporazuma, stranka sporazuma pa je dolžna naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz sporazuma in ceno po kateri je naročnik blago kupil.

Naročnik je dolžan stranki sporazuma poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju oz. stranki sporazuma, nato pa lahko izvrši kritni kup, sporazum pa je za to dobavo razdrt.

Šteje se, da je bila stranka sporazuma o nameravanem kritnem kupu obveščena, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz sporazuma je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, stranka sporazuma pa je dolžna razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V kolikor je naročnik primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s tem sporazumom 5-krat, se šteje sporazum s stranko sporazuma za to vrsto razdrt.

IX PLAČILNI POGOJI

10. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski račun št. odprt pri banki v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

Račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice.

Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

X SKRBNIK SPORAZUMA

11. člen

Skrbnik sporazuma za naročnika je:

Skrbnik sporazuma za stranko sporazuma je:

XI ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

12. člen

Stranke tega sporazuma ugotavljajo, da se določbe tega člena uporabljajo v primeru, ko ima naročnik za posamezne skupine blaga sklenjen samo sporazum, kot to izhaja iz osmega odstavka 4. člena tega sporazuma.

Stranka sporazuma bo morala v roku 5-ih dni od podpisa sporazuma kot instrument zavarovanja predložiti naročniku:

- garancijo (banke, zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti sporazuma, če bo vrednost enaka ali višja od 214.000,00 EUR brez DDV; oz.
- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% od vrednosti, sporazuma če bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 214.000,00 EUR brez DDV. Stranka sporazuma mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja sporazuma menica unovčljiva.

Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 10 dni od določenega obdobja veljavnosti sporazuma

V primeru vnovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo morala stranka sporazuma vnovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

V primeru, da stranka sporazuma za unovčenje menice na računu nima dovolj sredstev, bo naročnik z njo prekinil sporazum.

Naročnik bo menico oz. garancijo unovčil:

- če naročeno blago pri posamezni dobavi ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti ali
- stranka sporazuma 5x zaporedoma v roku ne dobavi blaga, razen v primeru višje sile.

XII SKLENITEV SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA

13. člen

Sporazum je sklenjen z dnem podpisa stranke sporazuma in naročnika ter, ko stranka sporazuma izroči naročniku instrument zavarovanja, v kolikor je le ta zahtevan skladno z določbo prvega odstavka 12. člena sporazuma.

V primeru osmega odstavka 4. člena tega sporazuma lahko stranki tega sporazuma skladno s 1. točko 95.člena ZJN-3 sporazumno podaljšata trajanje tega sporazuma s sklenitvijo aneksa k sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb sporazuma (dodatne nabave in podaljšanje veljavnosti sporazuma) velja omejitev 30 % za vrednost vseh sprememb skupaj.

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri stranki sporazuma ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če stranka sporazuma nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu stranka sporazuma ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega sporazuma bo naročnik obvestil stranko sporazuma.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

14. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti stranko sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo.

XIII POGODBENA KAZEN

15. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi stranke sporazuma, lahko naročnik stranki sporazuma zaračuna pogodbeno kazen, in sicer 100 EUR z DDV za vsak koledarski dan zamude.

Naročnik pogodbene kazni ne bo unovčil v primeru, ko stranka sporazuma naročnika, v roku 24 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani stranke sporazuma), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Naročnik mora stranki sporazuma zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo stranke sporazuma mora biti posredovano naročniku na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

XIV PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

16. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za

pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

XV KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja tega sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

18. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

19. člen

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Stranka sporazuma:

.....

Naročnik:

UKC Maribor

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
(v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka kupca za DDV: SI 56644817, matična
številka kupca: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

.....,
ki ga zastopa direktor
(v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV:
....., matična številka prodajalca:

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med prodajalcem in kupcem sklenjen okvirni sporazum, št., z dne, za nabavo blaga iz javnega naročila: »**MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO**«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave 6. 7. 2020, številka objave JN004262/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 7. 7. 2020, številka objave 2020/S 129-315777.

2. člen

Kupec je s pisnim povabilom k predložitvi ponudb št. 460-DeS-V1-77/20, z dne 3. 7. 2020 (v nadaljevanju: povabilo), pozval prodajalca k predložitvi ponudbe za dobavo blaga, opredeljenega v povabilu.

Na podlagi prodajalčeve ponudbe ter na podlagi merila za izbiro ponudb, opredeljenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, je kupec izbral prodajalca za dobavo posameznih skupin blaga, opredeljenih v Seznamu blaga s cenami (v nadaljevanju: Seznam).

Ponudba, Seznam in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

3. člen

Prodajalec in kupec se dogovorita, da bo kupec v obdobju, za katerega se sklepa ta pogodba, kupoval od prodajalca le tiste vrste in količine blaga iz Seznama, ki ga bo potreboval v tem obdobju.

4. člen

Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste blaga na podlagi pisnih naročilnic.

Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavila najkasneje v roku petih delovnih (5) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavila celotno količino naročenega blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo ob dobavi kupcu predložil navodila proizvajalca v slovenskem jeziku.

Dobavni rok se lahko v soglasju s kupcem podaljša, v kolikor pravočasna dobava ni mogoča iz razlogov razglašene epidemije, o čemer mora prodajalec kupca nemudoma obvestiti. Podaljšanje roka iz tega naslova je mogoča le v obdobju trajanja epidemije in v skladu z veljavno zakonodajo.

Prodajalec mora dostaviti blago ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče kupca.

Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga.

Predmet te pogodbe so tudi vse morebitne dodatne nabave blaga, ki jih bo potreboval kupec. Navedene nabave blaga bo kupec izvršil po cenah iz veljavne ponudbe, pri čemer se lahko pogodba spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje količine iz pogodbe ne sme presegati 30% prvotno predvidenih skupnih količin blaga (prvi odstavek 95. člena ZJN-3).

Za izvršitev zgoraj navedenih dobav bosta stranki te pogodbe sklenili aneks k tej pogodbi.

Kupec si pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, brez predhodne najave, zmanjša ali prekine nabavo določenih vrst blaga.

Prodajalec bo, v primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen ta sporazum (prenehanje proizvodnje,), oz. v primeru nadgradnje blaga (novejša generacija) pred pričetkom dobave novega blaga, kupcu predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazal, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od kupca pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

Če prodajalec ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, ima kupec pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju oz. pri drugi stranki sporazuma, prodajalec pa je dolžan kupcu nadomestiti razliko v ceni med ceno iz pogodbe in ceno po kateri je kupec blago kupil.

Kupec je dolžan prodajalcu poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju oz. pri drugi stranki sporazuma, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil prodajalec o nameravanem kritnem kupu obveščen, če kupec razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je kupec izvršil kritni kup in ceno iz pogodbe, je dolžan kupec dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, prodajalec pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V kolikor je kupec primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s to pogodbo 5-krat, se šteje pogodba s prodajalcem za te vrste blaga razdrta.

5. člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi e-dobavnice. E-dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po e-dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko.

Kataloške številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, ...) na vseh dokumentih (e-dobavnica, račun) in nalepki blaga ter škatli.

Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke o artiklu in črtno kodo, ki vsebuje serijsko številko in lot.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

6. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

7. člen

V času trajanja te pogodbe bo kupec od prodajalca kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.

Kupec si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je prodajalec za blago, ki je predmet te pogodbe, v času trajanja te pogodbe znižal cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s prodajalcem dogovoriti ustrezno znižanje pogodbene cene.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče kupca, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Cene iz ponudbe so fiksne v času trajanja te pogodbe.

8. člen

Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal prodajalcu na transakcijski račun prodajalca št. odprt pri banki v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

Račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice.

Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

9. člen

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

10. člen

Prodajalec bo moral v roku 5-ih dni od podpisa pogodbe kot instrument zavarovanja predložiti kupcu:

- garancijo (banke, zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe, če bo vrednost enaka ali višja od 214.000,00 EUR brez DDV; oz.
- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% od vrednosti, pogodbe če bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 214.000,00 EUR brez DDV. Prodajalec mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe menica unovčljiva.

Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 10 dni od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.

V primeru vnovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral prodajalec unovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

V primeru, da prodajalec za unovčenje menice na računu nima dovolj sredstev, bo naročnik z njim prekinil pogodbo.

Kupec bo menico oz. garancijo unovčil:

- če naročeno blago pri posamezni dobavi ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti ali
- prodajalec 5x zaporedoma v roku ne dobavi blaga, razen v primeru višje sile.

11. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje od do Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, in ko prodajalec kupcu predloži instrument zavarovanja iz 10. člena te pogodbe.

Skladno s 1. točko 95.člena ZJN-3 lahko stranki te pogodbe sporazumno podaljšata trajanje te pogodbe s sklenitvijo aneksa k pogodbi. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve nove pogodbe.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb pogodbe (dodatne nabave in podaljšanje veljavnosti pogodbe) velja omejitev 30 % za vrednost vseh sprememb skupaj.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali
- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
 in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

12. člen

V primeru neizpolnjevanja obveznosti prodajalca po tej pogodbi, lahko kupec to pogodbo razdre.

13. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi prodajalca, lahko kupec prodajalcu zaračuna pogodbeno kazen, in sicer 100 EUR z DDV za vsak koledarski dan zamude.

Kupec pogodbene kazni ne bo unovčil v primeru, ko prodajalec kupca, v roku 24 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani prodajalca), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Kupec mora prodajalcu zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo prodajalca mora biti posredovano kupcu na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

14. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

15. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

16. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

.....

Kupec:

UKC Maribor

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKJE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE

Podatki o pravni osebi:

Naziv ponudnika:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

ID za DDV:

Matična številka:

Št. vpisa v sodni register (vložna številka):

Spodaj podpisani (naziv pooblastitelja):
pooblaščenec naročnika UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, da skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) za potrebe javnega naročila za nabavo blaga: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 6. 7. 2020, številka objave JN004262/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 7. 7. 2020, številka objave 2020/S 129-315777, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

To soglasje je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za nabavo blaga: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO.

Kraj in datum:

Žig in podpis pooblaščenca osebe
ponudnika:

.....

Navodilo:

- Obrazec je treba izpolniti in podpisati.
- Obrazec morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.
- Ponudnik naloži obrazec v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKÉ EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Osebni podatki:

Ime in priimek:

EMŠO:

Naslov stalnega/začasnega prebivališča:

Državljanstvo:

Spodaj podpisani (naziv pooblastitelja):
pooblaščan naročnika UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, da skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) za potrebe javnega naročila za nabavo blaga: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 6. 7. 2020, številka objave JN004262/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 7. 7. 2020, številka objave 2020/S 129-315777, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

To soglasje je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za nabavo blaga: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ANESTEZIOLOGIJO.

Kraj in datum:

Podpis pooblastitelja:

.....

Navodilo:

- Obrazec je treba izpolniti in podpisati.
- Obrazec morajo izpolniti osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Obrazec morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.
- Ponudnik naloži obrazec v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
001 Filtri, dihalni sistemi in drugi pripomočki - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Anestezijska maska, oblazinjena, neonatalna, z mešičkom in ventilom za napihovanje, odišavljena, prozorna. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	584991	KOS	400				
2	Anestezijska maska, oblazinjena, otroška, z mešičkom in ventilom za napihovanje, odišavljena, prozorna. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388548	KOS	1.500				
3	Anestezijska maska, oblazinjena, za dojenčke, z mešičkom in ventilom za napihovanje, odišavljena, prozorna. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388530	KOS	300				
4	Anestezijska maska, oblazinjena, za odrasle, velikost »L« ali ustrezne številčne velikosti, z mešičkom in ventilom za napihovanje, prozorna, neodišavljena. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388459	KOS	3.000				
5	Anestezijska maska, oblazinjena, za odrasle, velikost »M« ali ustrezne številčne velikosti, z mešičkom in ventilom za napihovanje, prozorna, neodišavljena. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388467	KOS	5.500				
6	Anestezijska maska, oblazinjena, za odrasle, velikost »S« ali ustrezne številčne velikosti, z mešičkom in ventilom za napihovanje, prozorna, neodišavljena. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	437930	KOS	6.000				
7	Balon za anestezijo, volumen 1000 ml, brez lateksa, z zaščitno mrežo proti kolenčenju. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	430056	KOS	50				
8	Balon za anestezijo, volumen 2000 ml, brez lateksa, z zaščitno mrežo proti kolenčenju. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388815	KOS	300				
9	Balon za anestezijo, volumen 500 ml, brez lateksa, z zaščitno mrežo proti kolenčenju. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	977003	KOS	50				
10	Cevka za merjenje CO2. Vsebuje dodatni luer lock komolček, dolžina najmanj 2,4 m. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	386111	KOS	6.500				
11	Filter viralno - bakteriološki, elektrostatski, neonatalni. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977007	KOS	300				
12	Filter viralno - bakteriološki, elektrostatski. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	329479	KOS	15.000				
13	Filter viralno - bakteriološki, mehanski (HEPA). (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977006	KOS	5.000				
14	Filter viralno - bakteriološki, otroško /odrasli, elektrostatski. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977005	KOS	1.000				
15	Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	386138	KOS	12.000				
16	Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	386146	KOS	1.000				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
001 Filtri, dihalni sistemi in drugi pripomočki - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
17	Nastavek za tubus raztegljiv od 100 do največ 170 mm, z gibljivim komolčkom (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	729523	KOS	7.000				
18	Sistem dihalni za odrasle, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977001	KOS	1.000				
19	Sistem dihalni, dolžina cevi najmanj 1,6m, cevi premera 22mm, krak za balon vsaj 1,3m, balon 2L, z zaščito proti kolenčenju. Na inspiratorni in ekspiratorni cevi lovilnik vode. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	662585	KOS	6.000				
20	Sistem dihalni, dolžina cevi najmanj 2,4 m, cevi premera 22mm, krak za balon vsaj 1,5 m, balon 2L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Na inspiratorni in ekspiratorni cevi lovilnik vode. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	662577	KOS	2.000				
21	Sistem dihalni, neonatalni. Dolžina cevi najmanj 1,5 m, krak za balon najmanj 1 m, balon 0,5L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	977002	KOS	100				
22	Sistem dihalni, otroški. Dolžina cevi najmanj 1,5 m, cevi premera 15mm, krak za balon najmanj 1 m, balon 1L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	409898	KOS	500				
23	Sistem dihalni, za uporabo pri MR preiskavah. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	820024	KOS	300				
24	Sistem dihalni, za uporabo pri MR preiskavah. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	820059	KOS	300				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
002 Ostali pripomočki za anesteziologijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Cev za kisik, rebrasta, fragmentirana na razdalji med 160 in 170 mm, premer 22 mm in dolžine med 45 in 50 m. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	221180	KOS	10				
2	Cevka za kisik, dolžina najmanj 2 m, z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Raztegljive objemke na obeh koncih. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388513	KOS	8.750				
3	Cevka za merjenje CO2, notranji premer 1,2 mm. Vsebuje dodatni luer lock komolček premera 7,6 mm, dolžina 1,8 m. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	432814	KOS	1.500				
4	Cevka za merjenje CO2. Vsebuje dodatni luer lock komolček, dolžina 3,0 m. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	386120	KOS	1.000				
5	Cevka za merjenje in dovajanje kisika (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	388343	KOS	210				
6	CPAP sistem za tubus oz. kanilo. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	433594	KOS	100				
7	Držalo za cevi brez kovinskih delov z upogljivim nosilcem. Držalo ima na koncu nosilec s petimi utori. Dva utora sta premera 22 mm, dvema utoroma premera 15 mm in enim utorom premera 30 mm.	388793	KOS	20				
8	Kateter nosni za kisik dvorogi otroški, dolžina najmanj 2 m, nastavek za priključitev na povezovalno cev. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	423912	KOS	400				
9	Kateter nosni za kisik, dvorogi za dojenčke. Dolžina katetra najmanj 2 m. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Kateter brez PHT-ja in lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	660132	KOS	10				
10	Kateter nosni za kisik, dvorogi za nedonošenčke. Dolžina katetra najmanj 2 m. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Kateter brez PHT-ja in lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	832758	KOS	10				
11	Kateter nosni za kisik, dvorogi za odrasle, dolžine najmanj 2 m. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. V ušesnem predelu mora biti cev oblažljena proti razjedam. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388734	KOS	11.000				
12	Komolček gibljivi 22M-15F/15M. gibljiv okoli osi na obeh straneh, komolček ne sme vsebovati odprtin. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388661	KOS	30				
13	Konekt za cev - elastičen. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	334634	KOS	2				
14	Konekt za kisik 22M/15F s konusnim nastavkom 6,5 mm, posamezno pakiran. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	336777	KOS	140				
15	Konekt 15M/22M. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	430048	KOS	200				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
002 Ostali pripomočki za anesteziologijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
16	Konekt 22F - 22M z zamaškom in odprtino 7,6 mm. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388556	KOS	250				
17	Konekt 22F - 22M. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388432	KOS	2				
18	Konektor T, dimenzije: 22F * 22M* 22M/15F. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	429449	KOS	1.800				
19	Konektor T, dimenzije: 22M*22M/15F*22M in port za sesanje 7,6 mm s pritrjenim poklopcem. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388564	KOS	1.500				
20	Maska oblazinjena za CPAP inhalator - odrasla (S) (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	532754	KOS	150				
21	Maska za dovod 100% kisika z enim enosmernim ventilom in indikatorjem dihanja, za otroke. Dolžina cevke najmanj 2m, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	563919	KOS	30				
22	Maska za dovod 100% kisika za odrasle, maska ima nosni stišček, dolžina cevi najmanj 2 m, prozorna, brezbarvna, z indikatorjem dihanja. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	563927	KOS	900				
23	Maska za kisik za odrasle, ne vsebuje PVC, ima cevko za kisik dolžine najmanj 2 m. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	750093	KOS	10.000				
24	Maska za kisik za otroke s stiščkom in s cevjo, dolžine najmanj 2 m, z zaščito proti kolenčenju. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	424552	KOS	330				
25	Maska za nebulizer, otroška, z gibljivim konektom. Brez PVC. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388491	KOS	1.000				
26	Maska za nebulizer, za odrasle, brez PVC, s stiščkom z gibljivim nastavkom 22M. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388505	KOS	4.500				
27	Maska za nebulizer, za odrasle, srednja, z ventilom. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	423939	KOS	1.000				
28	Nastavek za aerosol terapijo za bolnike na ventilatorju, konekt 22M/22F z gibljivo razpršilno šobo. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	611522	KOS	250				
29	Nastavek za aerosol terapijo za bolnike na ventilatorju, kontekst 15M-15F z gibljivo razpršilno šobo. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388688	KOS	2				
30	Nastavek za tubus, raztegljiv od 100 mm do največ 170 mm, gibljivim komolčkom, z odprtino za aspiracijo. Konekt pri dihalnem sistemu premera 22 mm. Sterilen. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	977004	KOS	1.000				
31	Nastavek za tubus, raztegljiv od 100 mm do največ 170 mm, z gibljivim komolčkom. Konekt pri dihalnem sistemu premera 22 mm. Nesterilen. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388807	KOS	4.000				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
002 Ostali pripomočki za anesteziologijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
32	Nebulizer HOT TOP. Pri pretoku 8 L/min morajo biti delci manjši od 5 mikronov. Z navojem za pritrditev cevke. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	439223	KOS	1.800				
33	Nebulizer HOT TOP. 72% skupnega volumna delcev je pri pretoku 8 L/min manjših od 5 mikronov, izhod je 0,50 g/min. Komplet za odrasle z masko s stišč. cevko z navojem. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	528838	KOS	8.700				
34	Nebulizer za zdravila s samozapornim T konektom. Pri pretoku 8 L/min zagotavlja delce manjše od 5 mikronov, učinkovitost vsaj 74%, komplet s cevko. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	500666	KOS	1.300				
35	Nebulizer za zdravila s T konektom. Pri pretoku 8 L/min zagotavlja delce manjše od 5 mikronov, učinkovitost vsaj 74%, komplet s cevko. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388360	KOS	800				
36	Nebulizer za zdravila z alveolarno depozicijo (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	388769	KOS	200				
37	Nebulizer za zdravila z masko za odrasle. Pri pretoku 8 L/min mora zagotavljati delce manjše od 5 mikronov, učinkovitost vsaj 74%, komplet z obrazno masko, gibljivim konektom in cevko. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388378	KOS	50				
38	Nebulizer za zdravila, pri pretoku 8 L/min zagotavlja delce manjše od 5 mikronov, učinkovitost vsaj 74%. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388475	KOS	2.000				
39	Nebulizer za zdravila, 90% skupnega volumna delcev je pri pretoku 8 L/min manjših od 2 mikrona. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388483	KOS	100				
40	Ročni dihalnik komplet, volumen 1500 ml, ne vsebuje lateksa, s cevko za kisik dolžine najmanj 2 m, z zaščito proti kolenčenju in rezervoarjem za kisik. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388408	KOS	400				
41	Ročni dihalnik komplet, volumen 280 ml, ne vsebuje lateksa, s cevko za kisik dolžine najmanj 2 m, z zaščito proti kolenčenju in rezervoarjem za kisik. Komolček ima varovalni ventil. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	425478	KOS	5				
42	Ročni dihalnik komplet, za otroke, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	578916	KOS	15				
43	Ročni dihalnik, komplet, volumen 1L, za otroke. Vsebuje cevko za kisik, dolžine najmanj 2 m in zaščito proti kolenčenju ter rezervoarjem za kisik. Komolček z varovalnim ventilom. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	425486	KOS	40				
44	Sistem dihalni za CPAP z masko - veliko za odrasle, s cevko za merjenje pritiska, z inspiratorno cevjo prem. 22mm in dvema CPAP ventiloma (5 cm H2O, 20 cm H2O). Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	750689	KOS	400				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
002 Ostali pripomočki za anesteziologijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
45	Sistem dihalni, brez grelne žice, dolžina cevi najmanj 1,6m, premer 22mm. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388351	KOS	550				
46	Ventil PEEP 5 cm H2O pritiska za CPAP sistem, prozoren, barvna oznaka nastavitve pritiska. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	751324	KOS	80				
47	Venturi ventil za kisik 24%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388599	KOS	1.000				
48	Venturi ventil za kisik 28%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388602	KOS	1.900				
49	Venturi ventil za kisik 31%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388629	KOS	1.300				
50	Venturi ventil za kisik 35%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388637	KOS	1.200				
51	Venturi ventil za kisik 40%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388645	KOS	2.300				
52	Venturi ventil za kisik 50%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	695831	KOS	10				
53	Venturi ventil za kisik 60%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388653	KOS	1.300				
54	Vlažilec za tubus in kanilo - nos umetni (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	388394	KOS	6.500				
55	Vlažilec za tubus in kanilo s cevjo za kisik - nos umetni. Povračilo vlage pri VT 500 ml = 27mg H2O/L. Zavarovana odprtina za aspiracijo s pokrovom, ki je pritrjen na rob odprtine. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	329851	KOS	300				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
003 Potrošni material za avtologno transfuzijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Cev za aspiracijo krvi iz operativnega polja z linijo za antikoagulacijo in nastavkom za aspirator. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	485225	KOS	50				
2	Set za izpiranje in koncentriranje krvi iz operativnega polja. Kompatibilen z aparatom za koncentracijo eritrocitov. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	424722	KOS	800				
3	Zbiralnik za zbiranje krvi iz operativnega polja. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	424714	KOS	50				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
004 Pripomočki za aspiracijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Fleksibilna aspiracijska vrečka volumna od 1000 ml do 1200 ml. Z hidrofobnim zapornim filtrom in odprtino za možnost dodajanja želirnega praška. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	418293	KOS	700				
2	Fleksibilna aspiracijska vrečka volumna 2000 ml. Z hidrofobnim zapornim filtrom in odprtino za možnost dodajanja želirnega praška. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	418307	KOS	3.000				
3	Fleksibilna aspiracijska vrečka volumna 3000 ml. Z hidrofobnim zapornim filtrom in odprtino za možnost dodajanja želirnega praška. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	420646	KOS	2.500				
4	Prašek želirni, pakiranje od 20 g do 30 g. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	418323	KOS	12.000				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
005 Sistemi za merjenje tlaka - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Zaprta sistem za invazivno merjenje enega krvnega tlaka s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	477141	KOS	3.000				
2	Zaprta sistem za invazivno vzporedno merjenje dveh tlakov s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	406872	KOS	2.500				
3	Zaprta sistem za invazivno vzporedno merjenje treh tlakov s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	406031	KOS	500				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
006 Ustno-žrelni tubusi - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Ustno žrelni tubus, velikost 0, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	423041	KOS	50				
2	Ustno žrelni tubus, velikost 00, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	423050	KOS	100				
3	Ustno žrelni tubus, velikost 000, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	439576	KOS	100				
4	Ustno žrelni tubus, velikost 1, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	423033	KOS	100				
5	Ustno žrelni tubus, velikost 2, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388785	KOS	2.000				
6	Ustno žrelni tubus, velikost 3, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	421715	KOS	2.000				
7	Ustno žrelni tubus, velikost 4, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	421723	KOS	300				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
007 Laringoskopi za 1x uporabo - 100% skupina

CPV: 33100000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Laringoskop za 1x uporabo, tip MACINTOSH, velikost 1, dobra svetilnost (napredna LED svetloba), nizko-profilna lopatica, (BRITEPRO OMNI, 040-06-0110 ali ENAKOVREDNO).	977009	KOS	400				
2	Laringoskop za 1x uporabo, tip MACINTOSH, velikost 2, dobra svetilnost (napredna LED svetloba), nizko-profilna lopatica, (BRITEPRO OMNI, 040-04-0120 ali ENAKOVREDNO).	977008	KOS	500				
3	Laringoskop za 1x uporabo, tip MACINTOSH, velikost 3, dobra svetilnost (napredna LED svetloba), nizko-profilna lopatica, (BRITEPRO OMNI, 040-04-0130 ali ENAKOVREDNO).	105343	KOS	550				
4	Laringoskop za 1x uporabo, tip MACINTOSH, velikost 4, dobra svetilnost (napredna LED svetloba), nizko-profilna lopatica, (BRITEPRO OMNI, 040-04-0140 ali ENAKOVREDNO).	105344	KOS	300				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
008 Zamaški za infuzijski sistem - 100% skupina

CPV: 33100000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Zamašek za infuzijski sistem, brizgalke luer in luer lock, igle in kanile. Brez lateksa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. Bele barve.	977012	KOS	50.000				
2	Zamašek za infuzijski sistem, brizgalke luer in luer lock, igle in kanile. Brez lateksa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. Modre barve.	977011	KOS	50.000				
3	Zamašek za infuzijski sistem, brizgalke luer in luer lock, igle in kanile. Brez lateksa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. Rdeče barve.	977010	KOS	250.000				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo****009 Igle za blokado perifernega živčevja vidne pod UZ - 100% skupina**

CPV: 33100000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	Igla za periferno blokado živcev 22GX100-120 MM, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977015	KOS	150				
2	Igla za periferno blokado živcev 22GX50 MM, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977014	KOS	700				
3	Igla za periferno blokado živcev 22GX80 MM, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977013	KOS	700				

ŽIG IN PODPIS:

PRILOGA K SPECIFIKACIJI ZAHTEV NAROČNIKA

Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika:

SKLOP 1 – Filtri, dihalni sistemi in drugi pripomočki - 100% skupina

- **Ident 329479:** Filter viralno - bakteriološki, elektrostatski. Filter mora biti za dihalne volumne vsaj v območju od 300 do 1500 ml. Volumen mrtvega prostora je lahko največ 70 ml, upornost pri pretoku 30 L/min ne sme biti večja od 1,2 mbar. Luer lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 38 g. Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,999%. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 386146:** Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti za dihalne volumne vsaj v območju od 75 do 400 ml. Volumen mrtvega prostora je lahko največ 28 ml, upornost pri pretoku 15 L/min ne sme biti večja od 1,3 mbar. Luer lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 22 g. Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,99%. Zagotavljanje vlage mora biti vsaj 30 mg H₂O/L zraka. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 386138:** Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti za dihalne volumne vsaj v območju od 300 do 1500 ml. Volumen mrtvega prostora je lahko največ 68 ml, upornost pri pretoku 30 L/min ne sme biti večja od 1,2 mbar. Luer lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 38 g. Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,99%. Zagotavljanje vlage mora biti vsaj 28 mg H₂O/L zraka. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 977005:** Filter viralno - bakteriološki, otroško /odrasli, elektrostatski. Za dihalne volumne od 100 do 1500 ml, volumen mrtvega prostora je lahko največ 35 ml, upornost pri pretoku 30 L/min ne sme biti večja od 0,7 mbar. Teža filtra največ 35 g. Luer lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,99%. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 977006:** Filter viralno - bakteriološki, mehanski (HEPA). Za dihalne volumne vsaj v območju 300 – 1500 ml. Volumen mrtvega prostora je lahko največ 60 ml, upornost pri pretoku 30L/min ne sme biti večja od 1,4 mbar. Teža filtra največ 40 g. Luer lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,9999%. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 977007:** Filter viralno - bakteriološki, elektrostatski, neonatalni. Za dihalne volumne vsaj v območju od 30 do 150 ml. Volumen mrtvega prostora je lahko največ 15 ml, upornost pri pretoku 5 L/min ne sme biti večja od 0,5 mbar. Teža filtra največ 15 g. Luer lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,9%. Zagotavljanje vlage mora biti vsaj 33 mg H₂O/L zraka. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 729523:** Nastavek za tubus raztegljiv od 100 do največ 170 mm, z gibljivim komolčkom. Na komolčku mora biti odprtina za aspiracijo. Konekt pri dihalnem sistemu ima notranji premer 22 mm, nesterilen. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.

- **Ident 977001:** Sistem dihalni za odrasle, ogrevana inspiratorna in ekspiratorna cev, grelna žica mora biti intergirana v steno cevi, z vlažilno komoro, ki je kompatibilna z grelcem Fisher & Pajkel MR 850. Vsi materiali sestavnih delov za prenos plinov morajo biti brez PVC. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 820059:** Sistem dihalni, za uporabo pri MR preiskavah. Dolžina cevi najmanj 2,4 m, cevi premera 10-15 mm. Krak za balon vsaj 1,0 m, balon 1L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.

Opomba: Dihalni sistem in krak z balonom sta lahko pakirana v setu ali posamezno (če je pakiranje posamezno, je potrebno ponuditi isto 300 kom, letne količine).

- **Ident 820024:** Sistem dihalni, za uporabo pri MR preiskavah. Dolžina cevi najmanj 2,4 m, cevi premera 22 mm. Krak za balon vsaj 1,5 m, balon 2L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih..

Opomba: Dihalni sistem in krak z balonom sta lahko pakirana v setu ali posamezno. (če je pakiranje posamezno, je potrebno ponuditi isto 300 kom, letne količine).

SKLOP 2 – Ostali pripomočki za anesteziijo - 100% skupina

- **Ident 388343:** Cevka za merjenje in dovajanje kisika. Na eni strani objemka z notranjim premerom 5 mm in luer lock spojka s komolčkom premera 7,6 mm, na drugi strani komolček ločljiv od cevke. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 388769:** Nebulizer za zdravila z alveolarno depozicijo. V kompletu mora biti T konekt dimenzije 22F-22M-22M/15F in cevka za kisik z zaščito proti kolenčenju, dolžina najmanj 2m. Pri pretoku 8 L/min mora zagotavljati delce manjše od 2 mikronov in učinkovitost vsaj 75%. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 578916:** Ročni dihalnik komplet, za otroke, volumen 550 ml, brez lateksa, s cevko za kisik dolžine najmanj 2 m, z zaščito proti kolenčenju in rezervoarjem za kisik. Komolček med masko in balonom je z varnostno valvulo. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 388394:** Vlažilec za tubus in kanilo – nos umetni. Povračilo vlage pri VT 500 ml = 27 mg H₂O/L, zavarovana odprtina za aspiracijo s pritrjenim pokrovom. Varovalni mehanizem proti zadušitvi, gibljiv konekt. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.
- **Ident 532754:** Maska oblazinjena za CPAP inhalator - odrasla (S) z ventilom za polnjenje, nastavki za pritrditev, prozorna, mehki rob. Maska mora imeti vse potrebne priključne dele za priklop na dihalni sistem inhalatorja ter varovalne elemente za pacienta. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.

SKLOP 3 – Potrošni material za avtologno transfuzijo - 100% skupina

- **Ident 424722:** Set za izpiranje in koncentriranje krvi iz operativnega polja. Kompatibilen z aparatom za koncentracijo eritrocitov. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.

Set za izpiranje krvi naj vključuje:

1. Zbiralnik za zbiranje aspirirane krvi iz operativnega polja z 40 mikronskim filtrom, volumna 4 L, 2 x ¼ vhod aspiracijskih linij, ¼ vhod z luer zamaškom, vhod za podtlak in 3/8 izhod za izpust iz zbiralnika na spodnji strani.
 2. Glava centrifuge volumna do 200 ml oblike, ki omogoča intermitentno izpiranje krvi (se prilagaja spreminjajočemu volumnu posesane krvi s spreminjajočo hitrostjo izpiranja krvi). Izprana kri mora vsebovati vsaj 58% hematokrita in odstranjenih mora biti več kot 99% maščob.
 3. Cev za aspiracijo krvi iz operativnega polja z linijo za antikoagulacijo in nastavkom za aspirator.
 4. Vrečka za zbiranje odpadne tekočine volumna 10 L in z izpustom.
 5. Vrečka za zbiranje izprane krvi iz centrifuge s stiščki za zaporo in zamaški za za zapiranje izhodnih odprtín.
- **Ident 424714:** Zbiralnik za zbiranje krvi iz operativnega polja. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.

Zbiralnik za zbiranje aspirirane krvi iz operativnega polja z 40 mikronskim filtrom, volumna 4 L, 2 x ¼ vhod aspiracijskih linij, ¼ vhod z luer zamaškom, vhod za podtlak in 3/8 izhod za izpust iz zbiralnika na spodnji strani.

Ponudnik mora ponuditi v brezplačno uporabo 7 aparatov za avtologno transfuzijo, ki so kompatibilni s ponujenim potrošnim materialom za čas trajanja okvirnega sporazuma/kupoprodajne pogodbe in zagotoviti brezplačni servis. Delovanje aparata mora izpolnjevati vse strokovne zahteve, ki so opisane v specifikacijah pod identit **424722**, **424714** in **485225**.

Specifikacija opreme dane v brezplačno uporabo, mora biti priložena v ponudbi. Naveden mora biti tip ponujene opreme, proizvajalec in količina.

SKLOP 5 – Sistemi za merjenje tlaka - 100% skupina

- **Ident 477141:** Zaprt sistem za invazivno merjenje enega krvnega tlaka s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, integriranim bakterijskom filtrom in barvno označeno linijo. Zbiralnik za odvzem vzorca v obliki vrtljivega kolesčka s prostornino najmanj 2 ml, ki se po odvzemu popolnoma izprazni. Povezava z monitorjem preko kontaktne ploščice z enojnim kablom, varnostna fiksacija na klik. Sterilno pakirano, brez lateksa. MRI kompatibilne vse komponente, ki so potrebne za vzpostavitev monitoringa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.
- **Ident 406872:** Zaprt sistem za invazivno vzporedno merjenje dveh tlakov s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, integriranim bakterijskom filtrom in barvno označeno linijo. Pretvornika sta povezana na eno vrečko raztopine. Zbiralnik za odvzem vzorca v obliki vrtljivega kolesčka s prostornino najmanj 2 ml, ki se po odvzemu popolnoma izprazni. Povezava z monitorjem preko kontaktne ploščice z enojnim kablom, varnostna fiksacija na klik. Sterilno pakirano, brez lateksa. MRI

kompatibilne vse komponente, ki so potrebne za vzpostavitev monitoringa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.

- **Ident 406031:** Zaprt sistem za invazivno vzporedno merjenje treh tlakov s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, integriranim bakterijskom filtrom in barvno označeno linijo. Pretvorniki so povezani na eno vrečko raztopine. Zbiralnik za odvzem vzorca v obliki vrtljivega koleščka s prostornino najmanj 2 ml, ki se po odvzemu popolnoma izprazni. Povezava z monitorjem preko kontaktne ploščice z enojnim kablom, varnostna fiksacija na klik. Sterilno pakirano, brez lateksa. MRI kompatibilne vse komponente, ki so potrebne za vzpostavitev monitoringa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.

SKLOP 9 – Igle za blokado perifernega živčevja vidne pod UZ - 100% skupina

- **Ident 977013:** Igla za periferno blokado živcev 22GX80 MM, kompatibilna z nevrostimulatorji in vidna pod UZ. Imeti mora ergonomsko držalo ter 30 stopinjski poševni kot konice, omogočati mora gladko drsenje skozi tkiva. Imeti mora varnostni vzorec, ki definira pozicijo konice igle. Lasersko obdelana po celotni dolžini igle. Sterilna, brez lateksa. Za 1X uporabo. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.
- **Ident 977014:** Igla za periferno blokado živcev 22GX50 MM, kompatibilna z nevrostimulatorji in vidna pod UZ. Imeti mora ergonomsko držalo ter 30 stopinjski poševni kot konice, omogočati mora gladko drsenje skozi tkiva. Imeti mora varnostni vzorec, ki definira pozicijo konice igle. Lasersko obdelana po celotni dolžini igle. Sterilna, brez lateksa. Za 1X uporabo. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.
- **Ident 977015:** Igla za periferno blokado živcev 22GX100-120 MM, kompatibilna z nevrostimulatorji in vidna pod UZ. Imeti mora ergonomsko držalo ter 30 stopinjski poševni kot konice, omogočati mora gladko drsenje skozi tkiva. Imeti mora varnostni vzorec, ki definira pozicijo konice igle. Lasersko obdelana po celotni dolžini igle. Sterilna, brez lateksa. Za 1X uporabo. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
001 Filtri, dihalni sistemi in drugi pripomočki - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Anestezijska maska, oblazinjena, neonatalna, z mešičkom in ventilom za napihovanje, odišavljena, prozorna. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	584991	400	KOS				
2	Anestezijska maska, oblazinjena, otroška, z mešičkom in ventilom za napihovanje, odišavljena, prozorna. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388548	1.500	KOS				
3	Anestezijska maska, oblazinjena, za dojenčke, z mešičkom in ventilom za napihovanje, odišavljena, prozorna. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388530	300	KOS				
4	Anestezijska maska, oblazinjena, za odrasle, velikost »L« ali ustrezne številčne velikosti, z mešičkom in ventilom za napihovanje, prozorna, neodišavljena. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388459	3.000	KOS				
5	Anestezijska maska, oblazinjena, za odrasle, velikost »M« ali ustrezne številčne velikosti, z mešičkom in ventilom za napihovanje, prozorna, neodišavljena. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388467	5.500	KOS				
6	Anestezijska maska, oblazinjena, za odrasle, velikost »S« ali ustrezne številčne velikosti, z mešičkom in ventilom za napihovanje, prozorna, neodišavljena. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	437930	6.000	KOS				
7	Balon za anestezijo, volumen 1000 ml, brez lateksa, z zaščitno mrežo proti kolenčenju. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	430056	50	KOS				
8	Balon za anestezijo, volumen 2000 ml, brez lateksa, z zaščitno mrežo proti kolenčenju. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388815	300	KOS				
9	Balon za anestezijo, volumen 500 ml, brez lateksa, z zaščitno mrežo proti kolenčenju. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	977003	50	KOS				
10	Cevka za merjenje CO2. Vsebuje dodatni luer lock komolček, dolžina najmanj 2,4 m. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	386111	6.500	KOS				
11	Filter viralno - bakteriološki, elektrostatski, neonatalni. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977007	300	KOS				
12	Filter viralno - bakteriološki, elektrostatski. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	329479	15.000	KOS				
13	Filter viralno - bakteriološki, mehanski (HEPA). (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977006	5.000	KOS				
14	Filter viralno - bakteriološki, otroško /odrasli, elektrostatski. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977005	1.000	KOS				
15	Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	386138	12.000	KOS				
16	Filter viralno - bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	386146	1.000	KOS				
17	Nastavek za tubus raztegljiv od 100 do največ 170 mm, z gibljivim komolčkom (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	729523	7.000	KOS				
18	Sistem dihalni za odrasle, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977001	1.000	KOS				
19	Sistem dihalni, dolžina cevi najmanj 1,6m, cevi premera 22mm, krak za balon vsaj 1,3m, balon 2L, z zaščito proti kolenčenju. Na inspiratorni in ekspiratorni cevi lovilnik vode. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	662585	6.000	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
001 Filtri, dihalni sistemi in drugi pripomočki - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
20	Sistem dihalni, dolžina cevi najmanj 2,4 m, cevi premera 22mm, krak za balon vsaj 1,5 m, balon 2L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Na inspiratorni in ekspiratorni cevi lovilnik vode. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	662577	2.000	KOS				
21	Sistem dihalni, neonatalni. Dolžina cevi najmanj 1,5 m, krak za balon najmanj 1 m, balon 0,5L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	977002	100	KOS				
22	Sistem dihalni, otroški. Dolžina cevi najmanj 1,5 m, cevi premera 15mm, krak za balon najmanj 1 m, balon 1L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	409898	500	KOS				
23	Sistem dihalni, za uporabo pri MR preiskavah. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	820024	300	KOS				
24	Sistem dihalni, za uporabo pri MR preiskavah. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	820059	300	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:

289.946,55 €

0,00 €

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
002 Ostali pripomočki za anesteziologijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Cev za kisik, rebrasta, fragmentirana na razdalji med 160 in 170 mm, premer 22 mm in dolžine med 45 in 50 m. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	221180	10	KOS				
2	Cevka za kisik, dolžina najmanj 2 m, z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Raztegljive objemke na obeh koncih. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388513	8.750	KOS				
3	Cevka za merjenje CO2, notranji premer 1,2 mm. Vsebuje dodatni luer lock komolček premera 7,6 mm, dolžina 1,8 m. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	432814	1.500	KOS				
4	Cevka za merjenje CO2. Vsebuje dodatni luer lock komolček, dolžina 3,0 m. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	386120	1.000	KOS				
5	Cevka za merjenje in dovajanje kisika (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	388343	210	KOS				
6	CPAP sistem za tubus oz. kanilo. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	433594	100	KOS				
7	Držalo za cevi brez kovinskih delov z upogljivim nosilcem. Držalo ima na koncu nosilec s petimi utori. Dva utora sta premera 22 mm, dvema utoroma premera 15 mm in enim utorom premera 30 mm.	388793	20	KOS				
8	Kateter nosni za kisik dvorogi otroški, dolžina najmanj 2 m, nastavek za priključitev na povezovalno cev. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	423912	400	KOS				
9	Kateter nosni za kisik, dvorogi za dojenčke. Dolžina katetra najmanj 2 m. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Kateter brez PHT-ja in lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	660132	10	KOS				
10	Kateter nosni za kisik, dvorogi za nedonošenčke. Dolžina katetra najmanj 2 m. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. Kateter brez PHT-ja in lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	832758	10	KOS				
11	Kateter nosni za kisik, dvorogi za odrasle, dolžine najmanj 2 m. Z zaščito za preprečevanje kolenčenja. V ušesnem predelu mora biti cev oblazinjena proti razjedam. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388734	11.000	KOS				
12	Komolček gibljivi 22M-15F/15M. gibljiv okoli osi na obeh straneh, komolček ne sme vsebovati odprtin. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388661	30	KOS				
13	Konekt za cev - elastičen. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	334634	2	KOS				
14	Konekt za kisik 22M/15F s konusnim nastavkom 6,5 mm, posamezno pakiran. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	336777	140	KOS				
15	Konekt 15M/22M. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	430048	200	KOS				
16	Konekt 22F - 22M z zamaškom in odprtino 7,6 mm. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388556	250	KOS				
17	Konekt 22F - 22M. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388432	2	KOS				
18	Konektor T, dimenzije: 22F * 22M* 22M/15F. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	429449	1.800	KOS				
19	Konektor T, dimenzije: 22M*22M/15F*22M in port za sesanje 7,6 mm s pritrjenim poklopцем. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388564	1.500	KOS				
20	Maska oblazinjena za CPAP inhalator - odrasla (S) (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	532754	150	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
002 Ostali pripomočki za anesteziologijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
21	Maska za dovod 100% kisika z enim enosmernim ventilom in indikatorjem dihanja, za otroke. Dolžina cevke najmanj 2m, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	563919	30	KOS				
22	Maska za dovod 100% kisika za odrasle, maska ima nosni stišček, dolžina cevi najmanj 2 m, prozorna, brezbarvna, z indikatorjem dihanja. Brez lateksa. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	563927	900	KOS				
23	Maska za kisik za odrasle, ne vsebuje PVC, ima cevko za kisik dolžine najmanj 2 m. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	750093	10.000	KOS				
24	Maska za kisik za otroke s stiščkom in s cevjo, dolžine najmanj 2 m, z zaščito proti kolenčenju. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	424552	330	KOS				
25	Maska za nebulizer, otroška, z gibljivim konektom. Brez PVC. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388491	1.000	KOS				
26	Maska za nebulizer, za odrasle, brez PVC, s stiščkom z gibljivim nastavkom 22M. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	388505	4.500	KOS				
27	Maska za nebulizer, za odrasle, srednja, z ventilom. Preizkušena po trenutno veljavnih standardih.	423939	1.000	KOS				
28	Nastavek za aerosol terapijo za bolnike na ventilatorju, konekt 22M/22F z gibljivo razpršilno šobo. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	611522	250	KOS				
29	Nastavek za aerosol terapijo za bolnike na ventilatorju, kontekst 15M-15F z gibljivo razpršilno šobo. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388688	2	KOS				
30	Nastavek za tubus, raztegljiv od 100 mm do največ 170 mm, gibljivim komolčkom, z odprtino za aspiracijo. Konekt pri dihalnem sistemu premera 22 mm. Sterilen. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	977004	1.000	KOS				
31	Nastavek za tubus, raztegljiv od 100 mm do največ 170 mm, z gibljivim komolčkom. Konekt pri dihalnem sistemu premera 22 mm. Nesterilen. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388807	4.000	KOS				
32	Nebulizer HOT TOP. Pri pretoku 8 L/min morajo biti delci manjši od 5 mikronov. Z navojem za pritrditev cevke. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	439223	1.800	KOS				
33	Nebulizer HOT TOP. 72% skupnega volumna delcev je pri pretoku 8 L/min manjših od 5 mikronov, izhod je 0,50 g/min. Komplet za odrasle z masko s stišč. cevko z navojem. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	528838	8.700	KOS				
34	Nebulizer za zdravila s samozapornim T konektom. Pri pretoku 8 L/min zagotavlja delce manjše od 5 mikronov, učinkovitost vsaj 74%, komplet s cevko. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	500666	1.300	KOS				
35	Nebulizer za zdravila s T konektom. Pri pretoku 8 L/min zagotavlja delce manjše od 5 mikronov, učinkovitost vsaj 74%, komplet s cevko. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388360	800	KOS				
36	Nebulizer za zdravila z alveolarno depozicijo (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	388769	200	KOS				
37	Nebulizer za zdravila z masko za odrasle. Pri pretoku 8 L/min mora zagotavljati delce manjše od 5 mikronov, učinkovitost vsaj 74%, komplet z obrazno masko, gibljivim konektom in cevko. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388378	50	KOS				
38	Nebulizer za zdravila, pri pretoku 8 L/min zagotavlja delce manjše od 5 mikronov, učinkovitost vsaj 74%. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388475	2.000	KOS				
39	Nebulizer za zdravila, 90% skupnega volumna delcev je pri pretoku 8 L/min manjših od 2 mikrona. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388483	100	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
002 Ostali pripomočki za anesteziologijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
40	Ročni dihalnik komplet, volumen 1500 ml, ne vsebuje lateksa, s cevko za kisik dolžine najmanj 2 m, z zaščito proti kolenčenju in rezervoarjem za kisik. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388408	400	KOS				
41	Ročni dihalnik komplet, volumen 280 ml, ne vsebuje lateksa, s cevko za kisik dolžine najmanj 2 m, z zaščito proti kolenčenju in rezervoarjem za kisik. Komolček ima varovalni ventil. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	425478	5	KOS				
42	Ročni dihalnik komplet, za otroke, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	578916	15	KOS				
43	Ročni dihalnik, komplet, volumen 1L, za otroke. Vsebuje cevko za kisik, dolžine najmanj 2 m in zaščito proti kolenčenju ter rezervoarjem za kisik. Komolček z varovalnim ventilom. Brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	425486	40	KOS				
44	Sistem dihalni za CPAP z masko - veliko za odrasle, s cevko za merjenje pritiska, z inspiratorno cevjo prem. 22mm in dvema CPAP ventiloma (5 cm H2O, 20 cm H2O). Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	750689	400	KOS				
45	Sistem dihalni, brez grelne žice, dolžina cevi najmanj 1,6m, premer 22mm. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388351	550	KOS				
46	Ventil PEEP 5 cm H2O pritiska za CPAP sistem, prozoren, barvna oznaka nastavitve pritiska. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	751324	80	KOS				
47	Venturi ventil za kisik 24%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388599	1.000	KOS				
48	Venturi ventil za kisik 28%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388602	1.900	KOS				
49	Venturi ventil za kisik 31%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388629	1.300	KOS				
50	Venturi ventil za kisik 35%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388637	1.200	KOS				
51	Venturi ventil za kisik 40%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388645	2.300	KOS				
52	Venturi ventil za kisik 50%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	695831	10	KOS				
53	Venturi ventil za kisik 60%, posamezno pakiran, notranji premer 22mm, koncentracija kisika je označena z barvo, ki je različna od barve ventila. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388653	1.300	KOS				
54	Vlažilec za tubus in kanilo - nos umetni (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	388394	6.500	KOS				
55	Vlažilec za tubus in kanilo s cevjo za kisik - nos umetni. Povračilo vlage pri VT 500 ml = 27mg H2O/L. Zavarovana odprtina za aspiracijo s pokrovom, ki je pritrjen na rob odprtine. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	329851	300	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:

174.374,51 €

0,00 €

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**
003 Potrošni material za avtologno transfuzijo - 100% skupina

CPV: 33196000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Cev za aspiracijo krvi iz operativnega polja z linijo za antikoagulacijo in nastavkom za aspirator. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	485225	50	KOS				
2	Set za izpiranje in koncentriranje krvi iz operativnega polja. Kompatibilen z aparatom za koncentracijo eritrocitov. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	424722	800	KOS				
3	Zbiralnik za zbiranje krvi iz operativnega polja. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	424714	50	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:

105.287,50 €

0,00 €

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**

CPV: 33196000

004 Pripomočki za aspiracijo - 100% skupina

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Fleksibilna aspiracijska vrečka voluma od 1000 ml do 1200 ml. Z hidrofobnim zapornim filtrom in odprtino za možnost dodajanja želirnega praška. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	418293	700	KOS				
2	Fleksibilna aspiracijska vrečka voluma 2000 ml. Z hidrofobnim zapornim filtrom in odprtino za možnost dodajanja želirnega praška. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	418307	3.000	KOS				
3	Fleksibilna aspiracijska vrečka voluma 3000 ml. Z hidrofobnim zapornim filtrom in odprtino za možnost dodajanja želirnega praška. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	420646	2.500	KOS				
4	Prašek želirni, pakiranje od 20 g do 30 g. V skladu s trenutno veljavnimi standardi.	418323	12.000	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:

38.062,00 €

0,00 €

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobjePredmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**

CPV: 33196000

005 Sistemi za merjenje tlaka - 100% skupina

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Zaprta sistem za invazivno merjenje enega krvnega tlaka s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	477141	3.000	KOS				
2	Zaprta sistem za invazivno vzporedno merjenje dveh tlakov s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	406872	2.500	KOS				
3	Zaprta sistem za invazivno vzporedno merjenje treh tlakov s sistemom za brezigelni odvzem vzorca, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	406031	500	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:**133.912,50 €****0,00 €**

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**

CPV: 33196000

006 Ustno-žrelni tubusi - 100% skupina

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Ustno žrelni tubus, velikost 0, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	423041	50	KOS				
2	Ustno žrelni tubus, velikost 00, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	423050	100	KOS				
3	Ustno žrelni tubus, velikost 000, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	439576	100	KOS				
4	Ustno žrelni tubus, velikost 1, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	423033	100	KOS				
5	Ustno žrelni tubus, velikost 2, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	388785	2.000	KOS				
6	Ustno žrelni tubus, velikost 3, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	421715	2.000	KOS				
7	Ustno žrelni tubus, velikost 4, barvna oznaka velikosti, brez lateksa. Preizkušen po trenutno veljavnih standardih.	421723	300	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:

2.836,50 €

0,00 €

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**

CPV: 33100000

007 Laringoskopi za 1x uporabo - 100% skupina

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Laringoskop za 1x uporabo, tip MACINTOSH, velikost 1, dobra svetilnost (napredna LED svetloba), nizko-profilna lopatica, (BRITEPRO OMNI, 040-06-0110 ali ENAKOVREDNO).	977009	400	KOS				
2	Laringoskop za 1x uporabo, tip MACINTOSH, velikost 2, dobra svetilnost (napredna LED svetloba), nizko-profilna lopatica, (BRITEPRO OMNI, 040-04-0120 ali ENAKOVREDNO).	977008	500	KOS				
3	Laringoskop za 1x uporabo, tip MACINTOSH, velikost 3, dobra svetilnost (napredna LED svetloba), nizko-profilna lopatica, (BRITEPRO OMNI, 040-04-0130 ali ENAKOVREDNO).	105343	550	KOS				
4	Laringoskop za 1x uporabo, tip MACINTOSH, velikost 4, dobra svetilnost (napredna LED svetloba), nizko-profilna lopatica, (BRITEPRO OMNI, 040-04-0140 ali ENAKOVREDNO).	105344	300	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:

17.517,50 €

0,00 €

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**

CPV: 33100000

008 Zamaški za infuzijski sistem - 100% skupina

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Zamašek za infuzijski sistem, brizgalke luer in luer lock, igle in kanile. Brez lateksa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. Bele barve.	977012	50.000	KOS				
2	Zamašek za infuzijski sistem, brizgalke luer in luer lock, igle in kanile. Brez lateksa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. Modre barve.	977011	50.000	KOS				
3	Zamašek za infuzijski sistem, brizgalke luer in luer lock, igle in kanile. Brez lateksa. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. Rdeče barve.	977010	250.000	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:

6.265,00 €

0,00 €

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **077 Medicinski potrošni material za anesteziologijo**

CPV: 33100000

009 Igle za blokado perifernega živčevja vidne pod UZ - 100% skupina

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	Vredn. brez DDV
1	Igla za periferno blokado živcev 22GX100-120 MM, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977015	150	KOS				
2	Igla za periferno blokado živcev 22GX50 MM, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977014	700	KOS				
3	Igla za periferno blokado živcev 22GX80 MM, (za podrobnejši opis glej prilogo k specifikaciji zahtev naročnika).	977013	700	KOS				

ŽIG IN PODPIS:

VREDNOST SKUPAJ:

10.237,01 €

0,00 €